

# 海南师范大学

## 实验室安全检查整改通知

[2023] 24 号



被查单位： 化学与化工学院（桂林洋校区）

检查时间： 2023 年 11 月 13 日

检查组组长： 林惠文

检查组组员： 朱朝华 陈秀琼

整改完成期限： 2023 年 12 月 20 日

## 化学与化工学院：

根据《实验室安全管理工作规程（试行）》等文件精神，为确保实验室各项工作安全有序开展，我校实验室安全督导组对贵学院的实验室进行了安全检查。

检查发现实验室存在部分安全隐患，详情请见《2023年海南师范大学实验室安全现场检查报告》（附件1），请通知相应人员按要求进行整改。请贵院以点带面加强实验室日常管理，强化安全责任意识，及时落实相关实验室整改任务。接到整改通知的实验室完成整改后拍照提交学院，学院汇总形成整改报告（签字、盖章、附整改完成照片）统一提交到实验室建设与管理中心。整改期间，相关单位应当采取适当措施，确保实验室安全运行。

未按时完成整改或整改不到位的实验室，将关停实验室，实验室负责人提交整改方案，经学院及实验室建设与管理中心审核后由实验室进行整改。因实验室关停影响到师生正常教学、科研，由实验室负责人承担相应责任。情节严重的实验室将按照《关于印发〈海南师范大学实验室安全责任追究实施细则（试行）〉的通知》（海师办〔2023〕40号）对实验室负责人及所在单位进行责任追究。

联系人：吴老师 18976210803 地址：桂林洋校区综合实验楼303室

邮箱：[hslab@hainnu.edu.cn](mailto:hslab@hainnu.edu.cn)

附件1:2023年海南师范大学实验室安全现场检查报告

附件2:2023海南师范大学实验室安全现场检查整改报告



附件 1:

## 2023 年海南师范大学实验室安全 现场检查报告

学院名称: 化学与化工学院 (桂林洋校区)

检查时间: 2023 年 11 月 13 日

检查组组长: 林惠文

检查组组员: 朱朝华 陈秀琼

不符合项问题清单:

序号	条款号	问题事实描述	备注
1	13.4.4	化工学院: 化南 510, 化中 508 加热设备未张贴有高温警示标识提示和贴有安全操作规程。	化工学院: 化南 510, 化中 508
2	13.4.3	化工学院: 化中 507, 冰箱与墙壁间没散热空间	化工学院: 化中 507
3	9.7.2	化工学院: 化中 507 废液液面超过容量的 3/4, 周围放置有冰箱和气瓶。	化工学院: 化中 507
4	9.3.1	化工学院: 化中 508, 化中 507 实验室冰箱中存放的试剂没有动态台账清单, 有的自配溶液已放置多年没有使用。	化工学院: 化中 508, 化中 507
5	9.5.2	化工学院: 化南 109, 危化品仓库中的试剂进出库没有动态台帐清单, 无法查清危化品的流向。	化工学院: 化南 109

具体问题描述及对应照片:

### 一、13.4.4 问题

(1) 存在的问题描述：化工学院：化南 510，化中 508 加热设备未张贴有高温警示标识提示和贴有安全操作规程。

(2) 存在的问题照片：



化南 510



化中 508

### 二、13.4.3 问题

(1) 存在的问题描述：化工学院：化中 507，冰箱与墙壁间没散热空间。

(2) 存在的问题照片：



化中 507

### 三、9.7.2 的问题

(1) 存在的问题描述：化工学院：化中 507 废液液面超过容量的 3/4，周围放置有冰箱和气瓶。

(2) 存在的问题照片：



化中 507


### 四、9.3.1 的问题

(1) 存在的问题描述：化工学院：化中 508，化中 507 实验室冰箱中存放的试剂没有动态台账清单，有的自配溶液已放置多年没有使用。


(2) 存在的问题照片：



化中 508

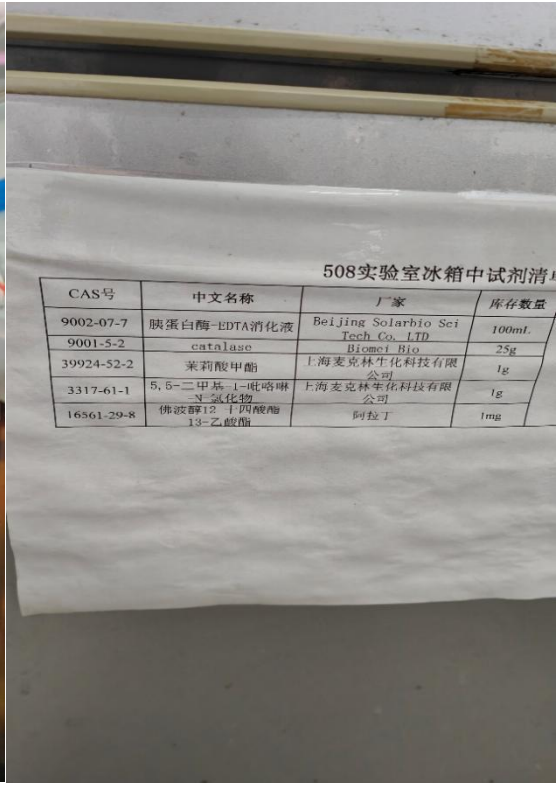


化中 508

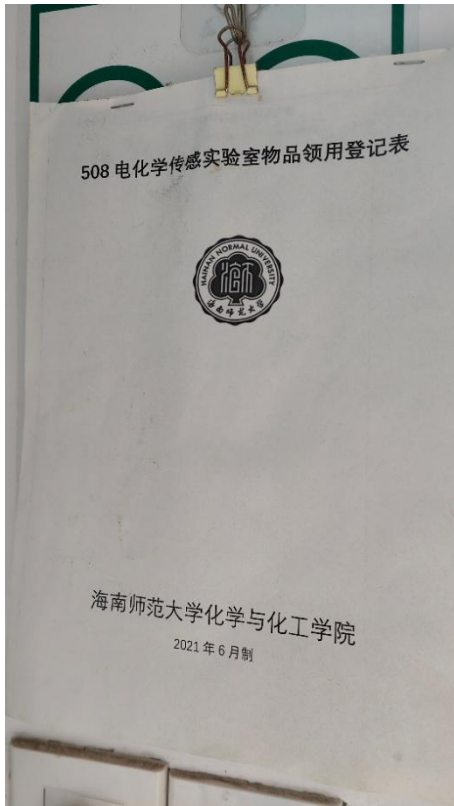

化中 508



化中 508

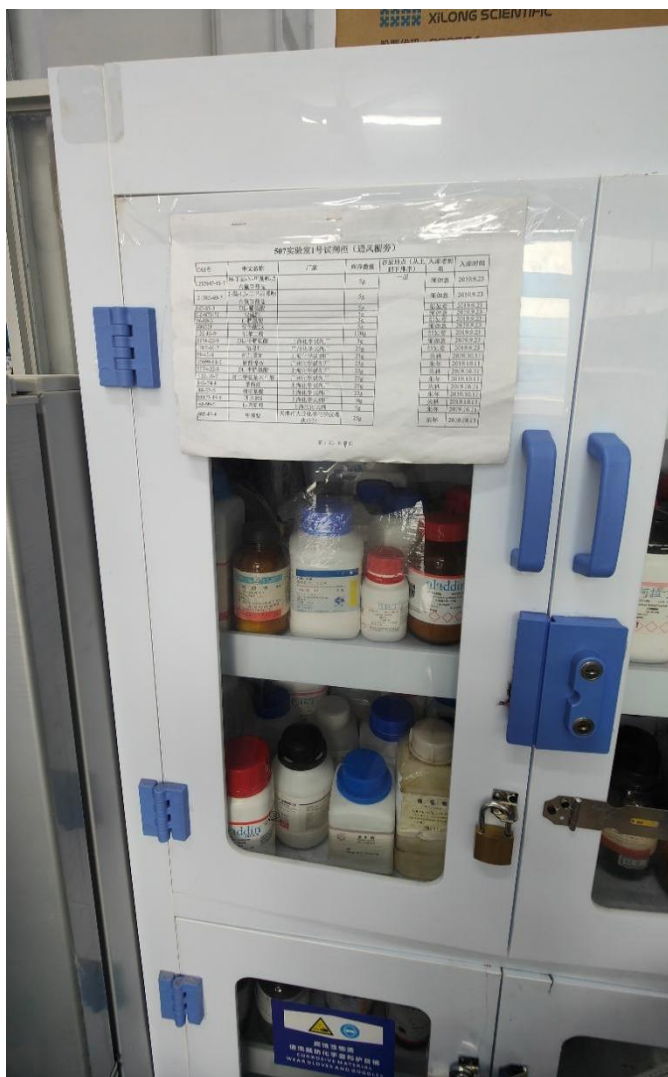

## 化中 507

### 五、9.5.2 的问题

(1) 存在的问题描述化工学院：化南 109，危化品仓库中的试剂进出库没有动态台帐清单，无法查清危化品的流向。

(2) 存在的问题照片：



化南 109



化南 109